

X線異物検査用標準試験片




石英ガラス球標準試験片 **FRQB**シリーズ

本製品は、純度 99.99% の合成石英ガラス材を使用しておりますので、材料に起因するバラツキ問題が無くなりました。

JIMA 標準試験片としてご使用いただけます。(注 1)

合成石英ガラス球	
材質	Si
純度	99.99%
比重	2.2g/cm ³

■ 5連式標準試験片

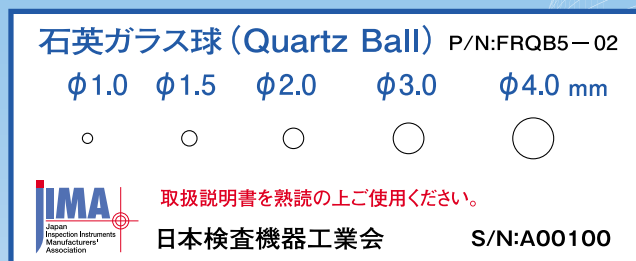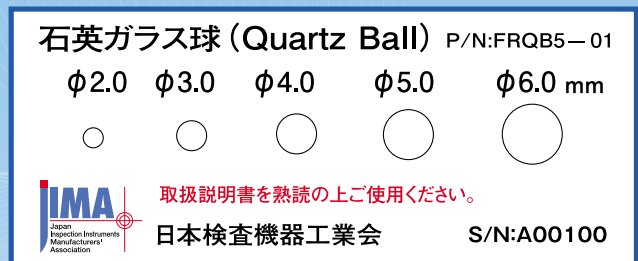

外形寸法：約 78×37mm

■ 単品標準試験片



P/N	球径mm	寸法公差mm
FRQB-1.0	1.0	±0.01
FRQB-1.5	1.5	±0.01
FRQB-2.0	2.0	±0.01
FRQB-3.0	3.0	±0.01
FRQB-4.0	4.0	±0.01
FRQB-5.0	5.0	±0.01
FRQB-6.0	6.0	±0.01
FRQB-7.0	7.0	±0.01
FRQB-8.0	8.0	±0.01



外形寸法：約 35×47mm

(注1):石英ガラス以外の既存試験片材料は、JIS等においても各成分許容範囲に幅があるため、材料に起因するばらつきによりX線透過度に差が生じます。

